



Inclinare la testa all'indietro e inserire il tampone orizzontalmente se si vuole effettuare un test nasofaringeo.

SECONDO PASSO

Oppure se si vuole effettuare un tampone orofaringeo, inclinare la testa all'indietro e mentre si emette il suono "Ah" inserire il tampone strofinando contro la parete faringea. Estrarre il tampone senza toccare altre pareti della bocca.









Mescolare delicatamente il tampone agitando il flacone.



Senza toccare il bordo della provetta, aggiungere 10 gocce alla provetta di estrazione.








Inserire il tampone con il campione nella provetta e farlo ruotare 10/15 volte, schiacciando la testa del tampone.



Attendere poi 2 minuti.








Mettere il tappo contagocce alla provetta e aggiungere due gocce nel pozzetto della cassetta per poi attendere 15 minuti per il risultato.

ANALISI RISULTATI

POSITIVO: Compare una linea nella regione T e una linea nella regione C.

NEGATIVO: Compare la linea rossa solo nella regione C.

INVALIDO: Non compare nessuna linea oppure compare solo nella regione T. Il test è da rifare.

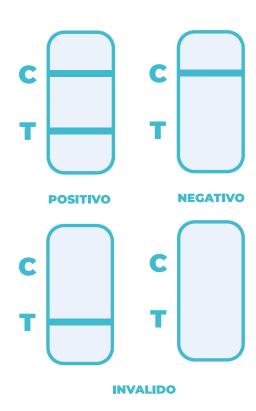

CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 2 - 30 C°.

Se non testati subito, i tamponi con i campioni devono essere conservati a una temperatura di 2 - 8 °C.

Il test andrà però eseguito entro 24H.